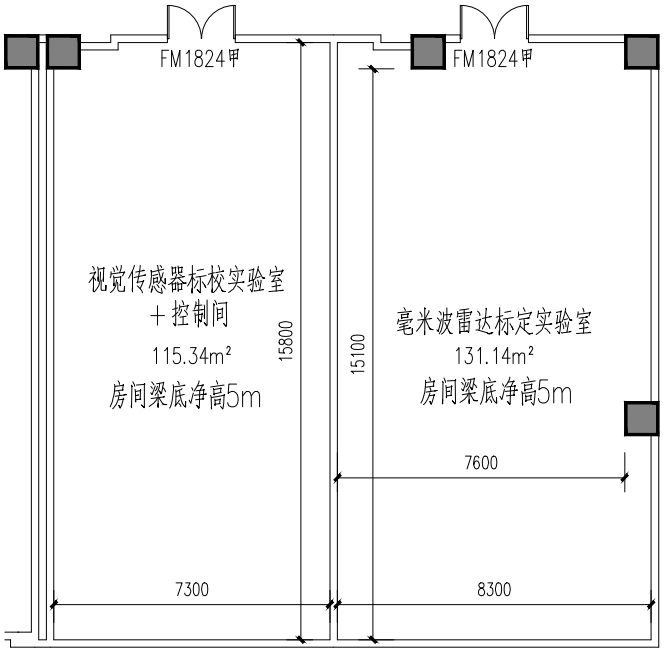
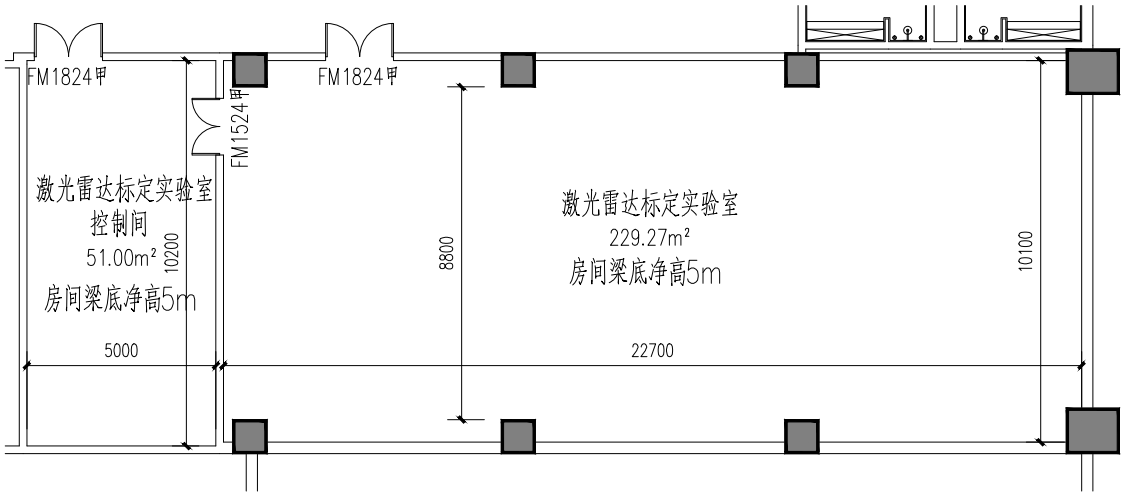

FM1824甲
FM1824甲
视觉传感器标校实验室
＋控制间
115.34m²
房间梁底净高5m
15800
15100
毫米波雷达标定实验室
131.14m²
房间梁底净高5m
7600
7300
8300


FM1824甲
FM1824甲
FM1524甲
激光雷达标定实验室
控制间
51.00m²
房间梁底净高5m
10200
8800
激光雷达标定实验室
229.27m²
房间梁底净高5m
10100
5000
22700