



合 同 书

甲 方： 北京市鼓楼中医医院

乙 方： 北京博达易通科技有限公司

地 区： 北 京

日 期： 2022.9.13

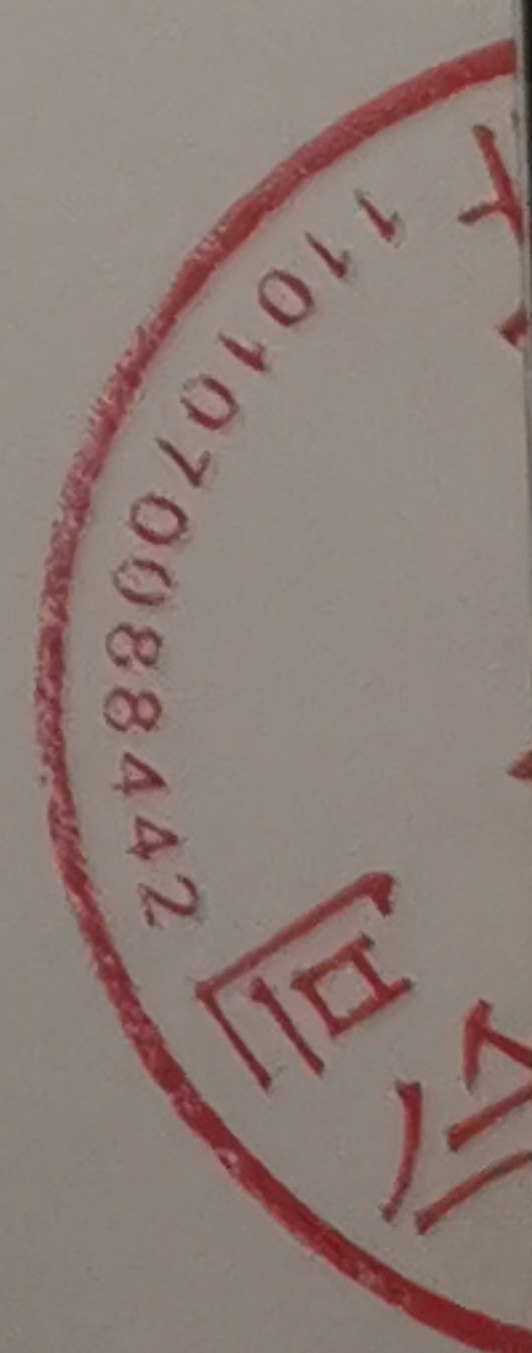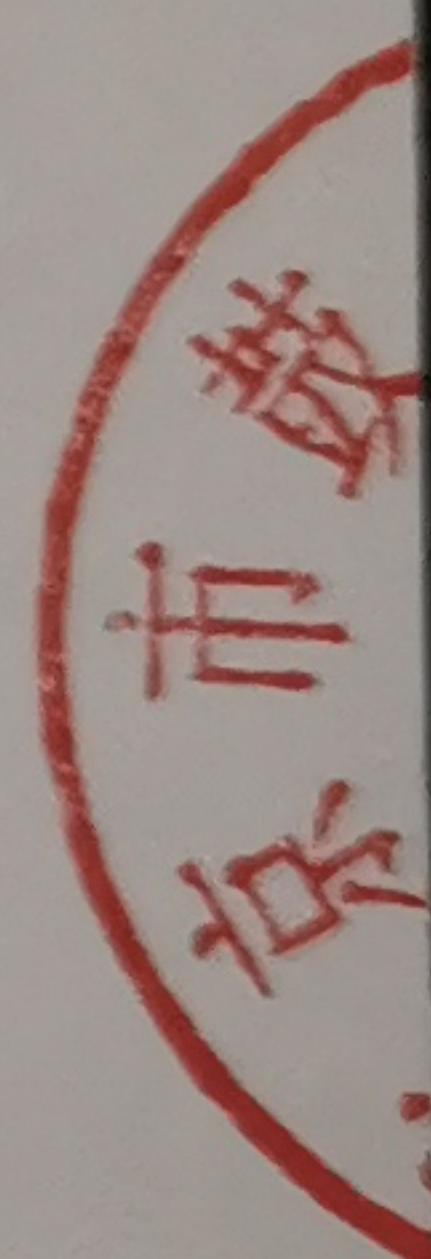

销售合同

甲方：北京市鼓楼中医医院

通讯地址：北京市东城区豆腐池胡同 13 号

纳税人识别号：12110101400782718L

电话：52273556

乙方：北京博达易通科技有限公司

通讯地址：北京市房山区辰光东路 16 号院 4 号楼 6 层 605

纳税人识别号：91110107330239989M

电话：13581995801

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，经甲乙双方充分、友好的协商，在平等自愿的基础上就甲方向乙方购买“针刀关节镜手术器械及配套设备”（以下简称“产品”）的事宜，签订本销售合同（以下简称“本合同”），合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。双方共同遵循以下所列条款：

1. 合同组成

- (1) 本合同；
- (2) 设备配置清单；
- (3) 代理商售后服务承诺函；
- (4) 培训方案；

2. 甲方向乙方购买的设备名称、规格型号、数量及价格：

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	单价 (元)	数量 (套)	总价 (元)
1	针刀关节镜手术器械 及配套设备	G020220	江西择高医疗科技有限公司	1196000	1	1196000

总计：¥1196000.00 元 （人民币）大写：壹佰壹拾玖万陆仟元整

3. 付款方式：

- 3.1. 本合同以人民币计价，往来合同款项以人民币支付。
- 3.2. 甲方将本合同总价的金额以电汇或支票方式汇到乙方指定账户。

乙方指定银行账户信息：

户 名：北京博达易通科技有限公司

开户银行：北京农商银行海淀新区支行农大分理处

账 号：0407030103000012077

4. 付款条件：

本合同的付款方式为：

- (1) 合同签订后 7 日内，买方向卖方支付合同总额 81% 的预付款，即人民币大写：玖拾陆万捌仟柒佰陆拾元整（小写：968760 元）；且卖方应先行开具 81% 的预付款的等额合法发票；因卖方开具发票迟延，买房付款相应迟延
 - (2) 买卖双方组织最终验收合格，卖方向买方提交下列文件资料后，在验收合格的叁年内，向卖方支付合同总额 19% 的尾款，即人民币大写：贰拾贰万柒仟贰佰肆拾元整（小写：227240 元）；
- A 设备验收报告；

B 卖方开具 贰拾贰万柒仟贰佰肆拾元整 (小写:227240 元) 的等额合法发票

(3) 如买方在最终验收合格后 12 个月内完成全额尾款支付, 卖方须在买方付清尾款前先行开具合同总额 3% 的银行履约保函 (或银行质量保函) 原件交乙方。

最终验收合格满 12 个月后七个工作日内, 如卖方交付的设备未发生产品质量问题及不存在违反售后服务承诺的问题, 买方将合同金额 3% 的银行履约保函 (或银行质量保函) 的原件退还给卖方。

5. 交货:

5.1. 发货时间: 双方签订合同并接到甲方通知后 3 个月内到货。

5.2. 交货地点: 甲方指定地点

5.3. 设备的所有权和损坏、损失等经济风险从设备交付, 并最终验收合格时起转移给甲方。

5.4. 乙方对于超出其合理控制范围的因素所引起的延迟交货 (包括但不限于由于甲方场地准备不及时或不符合条件、付款拖延等原因引起的延迟交货) 不承担责任。如发生上述事由, 乙方有权书面通知甲方并相应顺延交货期。

6. 包装: 按乙方标准货物包装。

7. 运输: 所供产品运费 (铁路、轮船、航空、邮政) 均由乙方承担。

8. 安装及保修

8.1. 乙方负责安排厂家 江西择高科技有限公司 (以下简称厂家) 的工程师对设备进行安装、调试和培训, 在厂家所指派的工程师完成调试和培训后, 由厂方向甲方发出《安装调试验收单》, 并由甲方签字盖章确认后, 视为甲方对货物正式验收, 货物所有权转移至甲方, 此后, 甲方才可对设备实际临床使用。如因甲方在安装验收前对货物进行私自操作, 产生的损失和后果由甲方自行负责, 乙方不承担任何责任。

8.2. 配置清单 (详请见附件 1) 所列设备全部由厂家和代理商负责提供保修服务, 保修期为六年, 自验收合格之日起算, 终身维护。保修期内每月对设备进行巡检, 包括主要零部件磨损情况, 安全隐患排查, 设备性能评估等内容, 出具巡查报告。《安装调试验收单》由甲方签字盖章确认后视为设备保修期的开始日期。设备终身维修响应时间 2 小时以内, 24 小时内到达现场并提供维修方案。返厂维修设备应在取走仪器后两天内通知预计送回时间, 以便临床合理安排工作。保修期内急诊急救设备需提供备用机。过保修期只收取配件费, 不得收取上门服务费。设备涉及配套软件的终身免费在原主机重新安装、维护、升级。因更换电脑主机原因可免费延续上述软件服务。上述保修承诺由代理商开具售后服务承诺书 (详请见附件 2)。

9. 对设备提出异议的时间和方式

9.1. 甲方在货物最终验收合格前, 如果发现设备质量不合规定, 应在十天内向乙方提出书面异议及处理意见。如甲方未按规定期限提出书面异议, 视为所交设备不符合合同的规定。

9.2. 甲方因保管、保养不善等造成设备质量下降的, 不得对设备质量提出异议。

9.3. 乙方在收到甲方书面异议后，应在十天内负责处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。

10. 违约条款：

乙方应按照合同约定及时交付本合同项下的设备，迟延交付的，每迟延交付一日应向甲方支付应收款的 0.2%（千分之二）违约金，但因甲方的原因或不可抗力等因素所导致的迟延交付，乙方不承担责任。

11. 不可抗力：

11.1. 不可抗力范围：战争，火灾，台风，洪水，地震或其他双方共同认为属于不可抗力的原因或事件。

11.2. 若发生不可抗力事件，则须由受不可抗力事件影响的一方，取得权威机关的相关证明，并及时通知另一方。遭受不可抗力的一方凭此证明并根据遭受不可抗力的程度免除全部或部分违约责任，具体免除范围和方式另行协商。

11.3. 如需继续履行合同，受不可抗力影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知另一方，并通过特快专递通知另一方不可抗力已终结或排除并明确继续合同的履行。

12. 争议的解决：

由本合同引起的争议，双方应尽量通过友好协商的方式解决。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则合同主体任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

13. 附则：

13.1. 本合同与附件构成不可分割的一个整体。

13.2. 合同的补充：针对本合同中未尽的事宜，经双方协商一致后可签订书面补充协议，补充协议自双方盖章及法定代表人或其授权代表签字后生效。补充协议与本合同规定不一致的，以补充协议为准。

13.3. 本合同自双方盖章及法定代表人签字后生效。

13.4. 本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，各份均具有同等的法律效力。

以下无正文。

甲方（盖章）：



北京市鼓楼中医医院

单位法定代表人签字：

签订日期：

2022.9.13

乙方（盖章）：



北京博达易通科技有限公司

单位法定代表人签字：

签订日期：

2022.9.13

附件 1 产品配置清单表;

附件一：微创针刀镜手术器械及配套设备配置清单

序号	货物名称	生产厂商及品牌	规格型号	单位	数量	备注
1	医用一体化内窥镜摄像系统	江西择高科技有 限公司、择高	G020220	套	1	
2	数据处理中心	联想（北京）有限 公司、联想	M415-B385	套	1	
3	医用加压器	江西择高科技有 限公司、择高	ZJ-01	套	1	
4	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z26	支	3	
5	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z35	支	3	
6	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z36	支	3	
7	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z44	支	3	
8	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z45	支	3	
9	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z53	支	3	
10	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z54	支	3	
11	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z29	支	3	
12	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z38	支	3	
13	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z39	支	3	
14	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z47	支	3	
15	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z48	支	3	
16	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z57	支	3	
17	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z32	支	3	
18	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z41	支	3	
19	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z42	支	3	
20	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z50	支	3	
21	关节冲洗针		ZG-ZDJ08-Z59	支	3	
22	刺探针		ZG-ZDJ08-Z06	支	2	
23	刺探针		ZG-ZDJ08-Z07	支	2	
24	松弛切刀		ZG-ZDJ08-D01	支	2	
25	拨松针（大圆头）		ZG-ZDJ08-Z11	支	2	
26	拨松针（锥头）		ZG-ZDJ08-Z16	支	2	
27	拨松针（锥头）		ZG-ZDJ08-Z15	支	2	
28	拨松针（圆头）		ZG-ZDJ08-Z12	支	4	
29	拨松针（圆头）		ZG-ZDJ08-Z13	支	2	
30	拨松针（圆头）		ZG-ZDJ08-Z14	支	2	
31	刺探针		ZG-ZDJ08-Z02	支	4	
32	刺探针		ZG-ZDJ08-Z03	支	2	
33	刺探针		ZG-ZDJ08-Z04	支	2	
34	拨松针（大圆头）		ZG-ZDJ08-Z09	支	2	
35	拨松针（大圆头）		ZG-ZDJ08-Z10	支	2	
36	兰剪杆状直型		ZG-ZDJ08-J06	把	1	

37	关节钳（平口钳）	江西择高科技有 限公司、择高	ZG-ZDJ08-Q04	把	1	
38	半月板兰钳左弯		ZG-ZDJ08-Q08	把	1	
39	半月板兰钳右弯		ZG-ZDJ08-Q09	把	1	
40	剥离钳		ZG-ZDJ08-Q12	把	1	
41	冲洗把手		ZG-ZDJ08STD01	把	3	
42	双阀镜鞘		ZG-ZDJ08-C02	套	2	
43	关节内窥镜		ZG-NKJ01	套	2	
44	医用台车		定制	张	1	
45	转运包装箱		定制	只	1	
46	关节内窥镜消毒盒		定制	只	2	
47	打印机	联想图像（天津） 有限公司、联想	CS1831	台	1	
48	器械消毒框	江西择高科技有 限公司、择高	定制	只	2	
49	针具消毒盒		定制	只	3	


配置清单

编号	型号	名称	规格	数量
1	B5720ZS	骨钻刨削器	8000-9500 转	1 套
2	U9622ZS	手控制器及连线	电机功率 50W	1 个
3	B5726ZS	斜口内齿切割器	4mm 直式	1 支
4	B5722ZS	平口全齿切割器	4mm 直式	1 支
5	B5721ZS	平口切割器	4mm 直式	1 支
6	B5747ZS	球形打磨钻	4mm 直式	1 支
7	J0200G	0° 内窥镜	Φ4×175mm	1 支
8	J0230G	30° 内窥镜	Φ4×175mm	1 支
9	J0270G	70° 内窥镜	Φ4×175mm	1 支
10	G4500	0° 双阀镜鞘	Φ5.5 mm×140mm	1 支
11	G4503	30° 双阀镜鞘	Φ5.5 mm×140mm	1 支
12	G4507	70° 双阀镜鞘	Φ5.5 mm×140mm	1 支
13	G4520	棱形穿刺针	Φ4.3 mm×175mm	1 支

14	G4540	钝形闭孔器	$\Phi 4.3 \text{ mm} \times 175 \text{ mm}$	1 支
15	G4502	穿刺套管	$\Phi 5.8 \text{ mm} \times 74 \text{ mm}$	1 支
16	G4542	穿刺针	$\Phi 5 \text{ mm} \times 93 \text{ mm}$	1 支
17	G5001	抓钳(半月板)	$\Phi 5 \text{ mm} \times 135 \text{ mm}$	1 把
18	G5002	滑膜钳(直式)	$\Phi 4 \text{ mm} \times 140 \text{ mm}$	1 把
19	G5003	活检钳(针定位)	$\Phi 3.6 \text{ mm} \times 145 \text{ mm}$	1 把
20	G5004	咬断钳(大力)	$\Phi 5 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$	1 把
21	G5013	兰钳(0°)	$\Phi 5 \text{ mm} \times 135 \text{ mm}$	1 把
22	G5014	兰钳(左 45°)	$\Phi 5 \text{ mm} \times 135 \text{ mm}$	1 把
23	G5016	兰钳(右 45°)	$\Phi 5 \text{ mm} \times 135 \text{ mm}$	1 把
24	G5302	弯剪(左)	$\Phi 3.5 \text{ mm} \times 140 \text{ mm}$	1 把
25	G5303	弯剪(右)	$\Phi 3.5 \text{ mm} \times 140 \text{ mm}$	1 把
26	G5304	直剪(月牙)	$\Phi 4 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$	1 把
27	G5901	直角探针	$3 \text{ mm} \times 120 \text{ mm}$	1 把
28	G5902	直角探针	$5 \text{ mm} \times 120 \text{ mm}$	1 把
29	G5401	拉刀(钩状)	$\Phi 3 \text{ mm} \times 105 \text{ mm}$	1 把
30	G5403	拉刀(反向)	$\Phi 3 \text{ mm} \times 105 \text{ mm}$	1 把
31	G5404	铲刀(直状)	$\Phi 3 \text{ mm} \times 105 \text{ mm}$	1 把
32	G5408	切刀(半月板)	$\Phi 3 \text{ mm} \times 105 \text{ mm}$	1 把
33	G5409	异型刀(玫瑰花形)	$\Phi 3 \text{ mm} \times 105 \text{ mm}$	1 把
34	G5410	异型刀(半园状)	$\Phi 3 \text{ mm} \times 105 \text{ mm}$	1 把
35	G5411	刮匙	$\Phi 3 \text{ mm} \times 105 \text{ mm}$	1 把
36	U8724	光缆	$\Phi 4 \times 2 \text{ m}$	1 条

过氧化氢低温等离子灭菌器 PS-100X 标准配置

1	主机	1 台
2	不锈钢篮筐	2 个
3	过氧化氢过滤器	1 个
4	打印纸	1 卷
5	真空泵油	2 升
6	漏斗	1 个

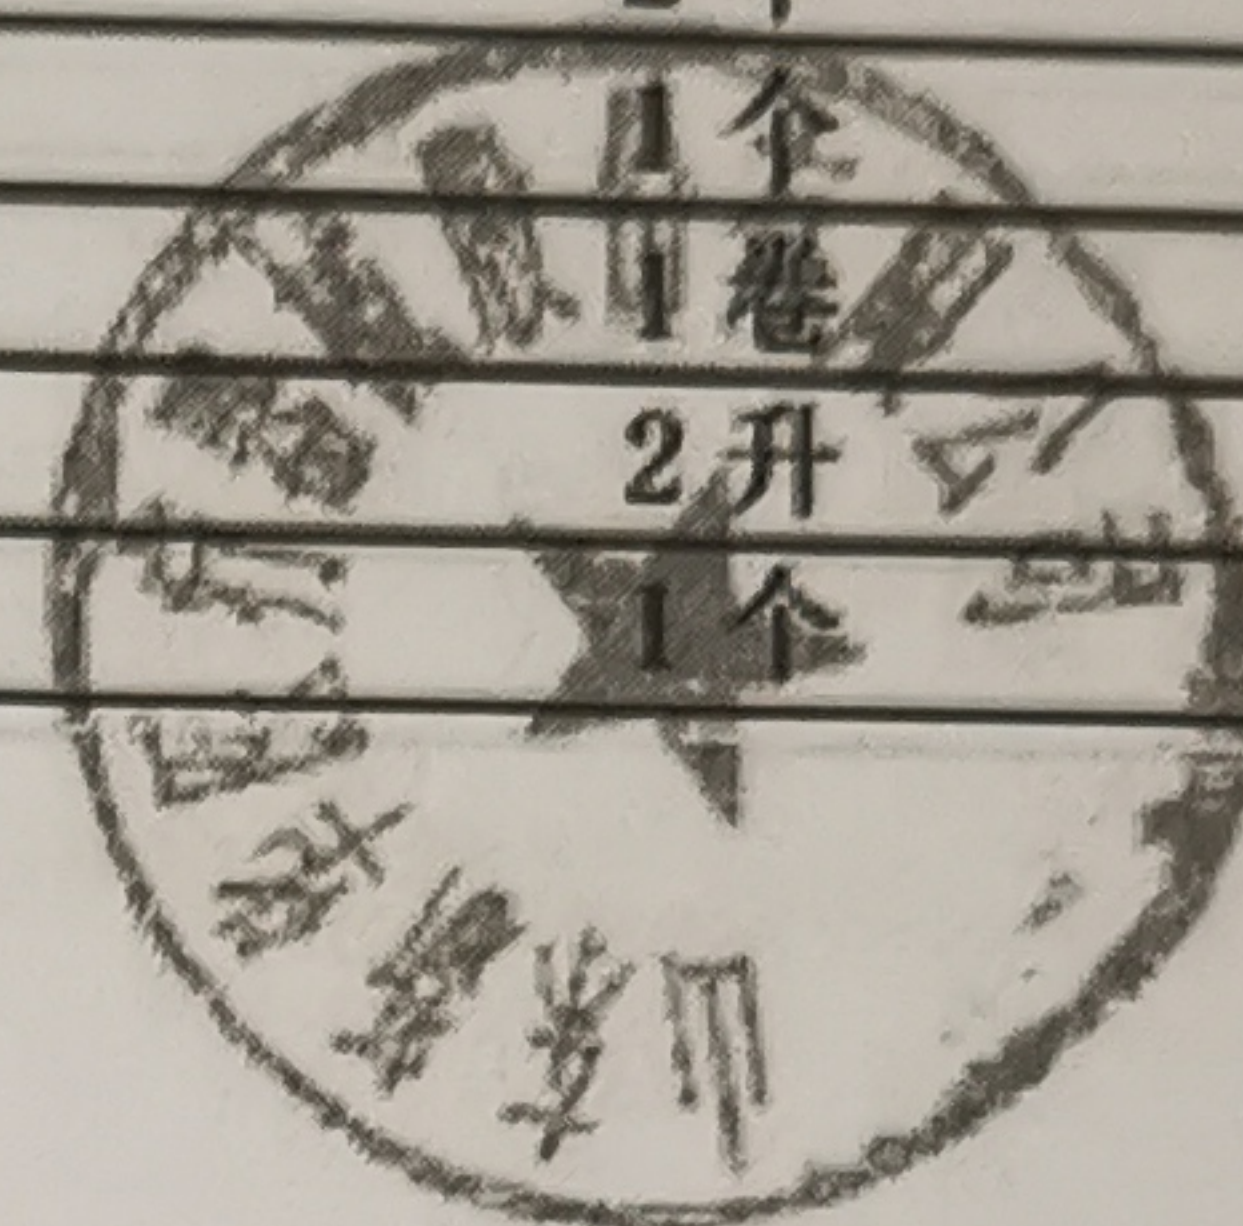

附件 2 代理商售后服务承诺函；

项目实施方案：

合同签订后，将在合同签字生效后指定时间内向需方交货并培训完成。

供货方负责设备的运输、安装、调试（如有要求需方准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为需方的操作和维护人员进行现场专业技术培训，包括设备的日常保养维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止；

设备保质期：

1. 设备安装调试验收合格后，免费质保期六年，终生维护。
2. 供货方负责设备的运输、安装、调试（如有要求需方准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为需方的操作和维护人员进行现场专业技术培训，包括设备的日常保养维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止；
3. 在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商需在 2 小时内响应，并保证在接到通知后工作日的 12 小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的 24 小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。如 48 小时内未能恢复正常使用，提供备用机代替使用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责；
4. 设备一年（365 天）内保证开机率 $\geq 95\%$ （按工作日计算），若达不到，则按停用时间的双倍顺延保修期；
5. 质保期外接到报修电话后 24 小时内到场解决问题，免收维修工时费，只收取配件费，设备零配件收费给予 ≤ 7 折优惠，用户享受终生免费软件升级；
6. 保证十年以上的配件供应；
7. 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后，10 天内将这些资料免费寄给买方。



附件 3 培训方案；

技术培训

提供专业培训师免费到需求方指定地点提供现场培训，直至需求方能完全操作。

专业的多样化培训方案，包括现场培训、相关医院设备临床培训、等多种免费培训方式，培训人数根据使用方情况而定。

为了使使用单位能正确使用本设备，更好地发挥设备的作用，特制定培训方案如下：

- 1、培训对象：用户指定科室。
- 2、培训地点：设备安装调试验收现场。

3、培训内容：

本设备的有关知识。

本设备的基本运行操作和软件使用。

本设备维修保养、小故障的正确判断与解决。

4、学习要求：

参加培训的所有人员必须在规定的时间内认真学习掌握相关知识及技术。

参加培训的所有人员都要做好学习笔记。

培训时间：设备安装调试完成后现场进行。

注：培训方案内容如与合同主体相关内容不符，应以有利于买方相关内容为准。

北京博达易通科技有限公司



廉洁购销合同

甲方：北京市鼓楼中医医院

乙方：北京博达易通科技有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：


一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销医用设备、医用耗材、药品等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪委、行风办等部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、

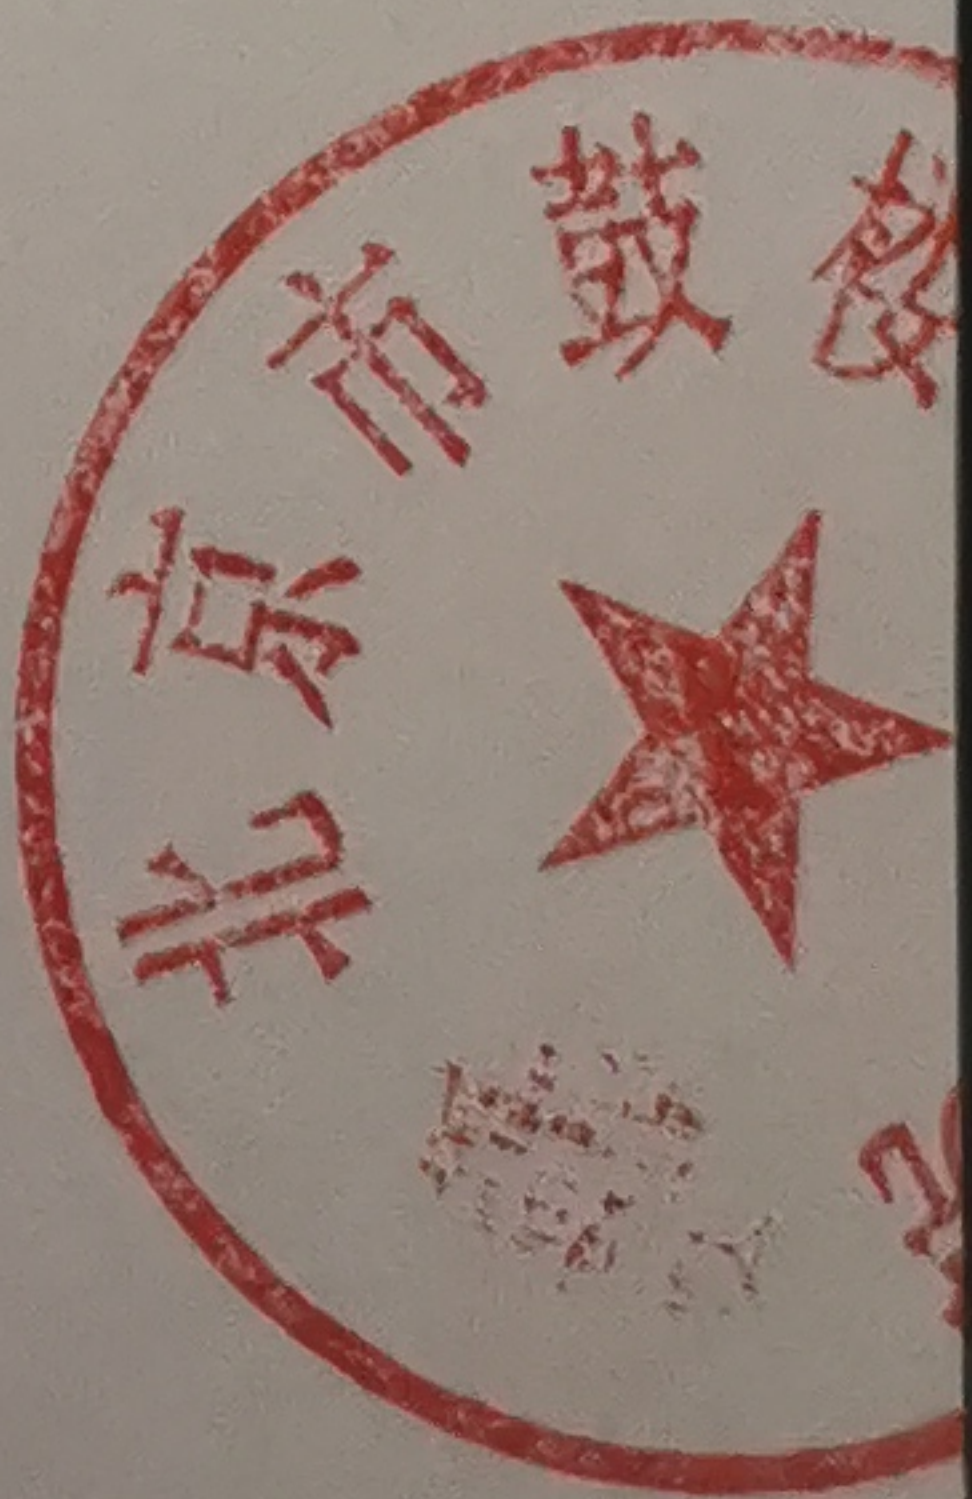

超标准支付食宿费用。


六、乙方指定白小龙作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲方二份乙方一份，并从双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

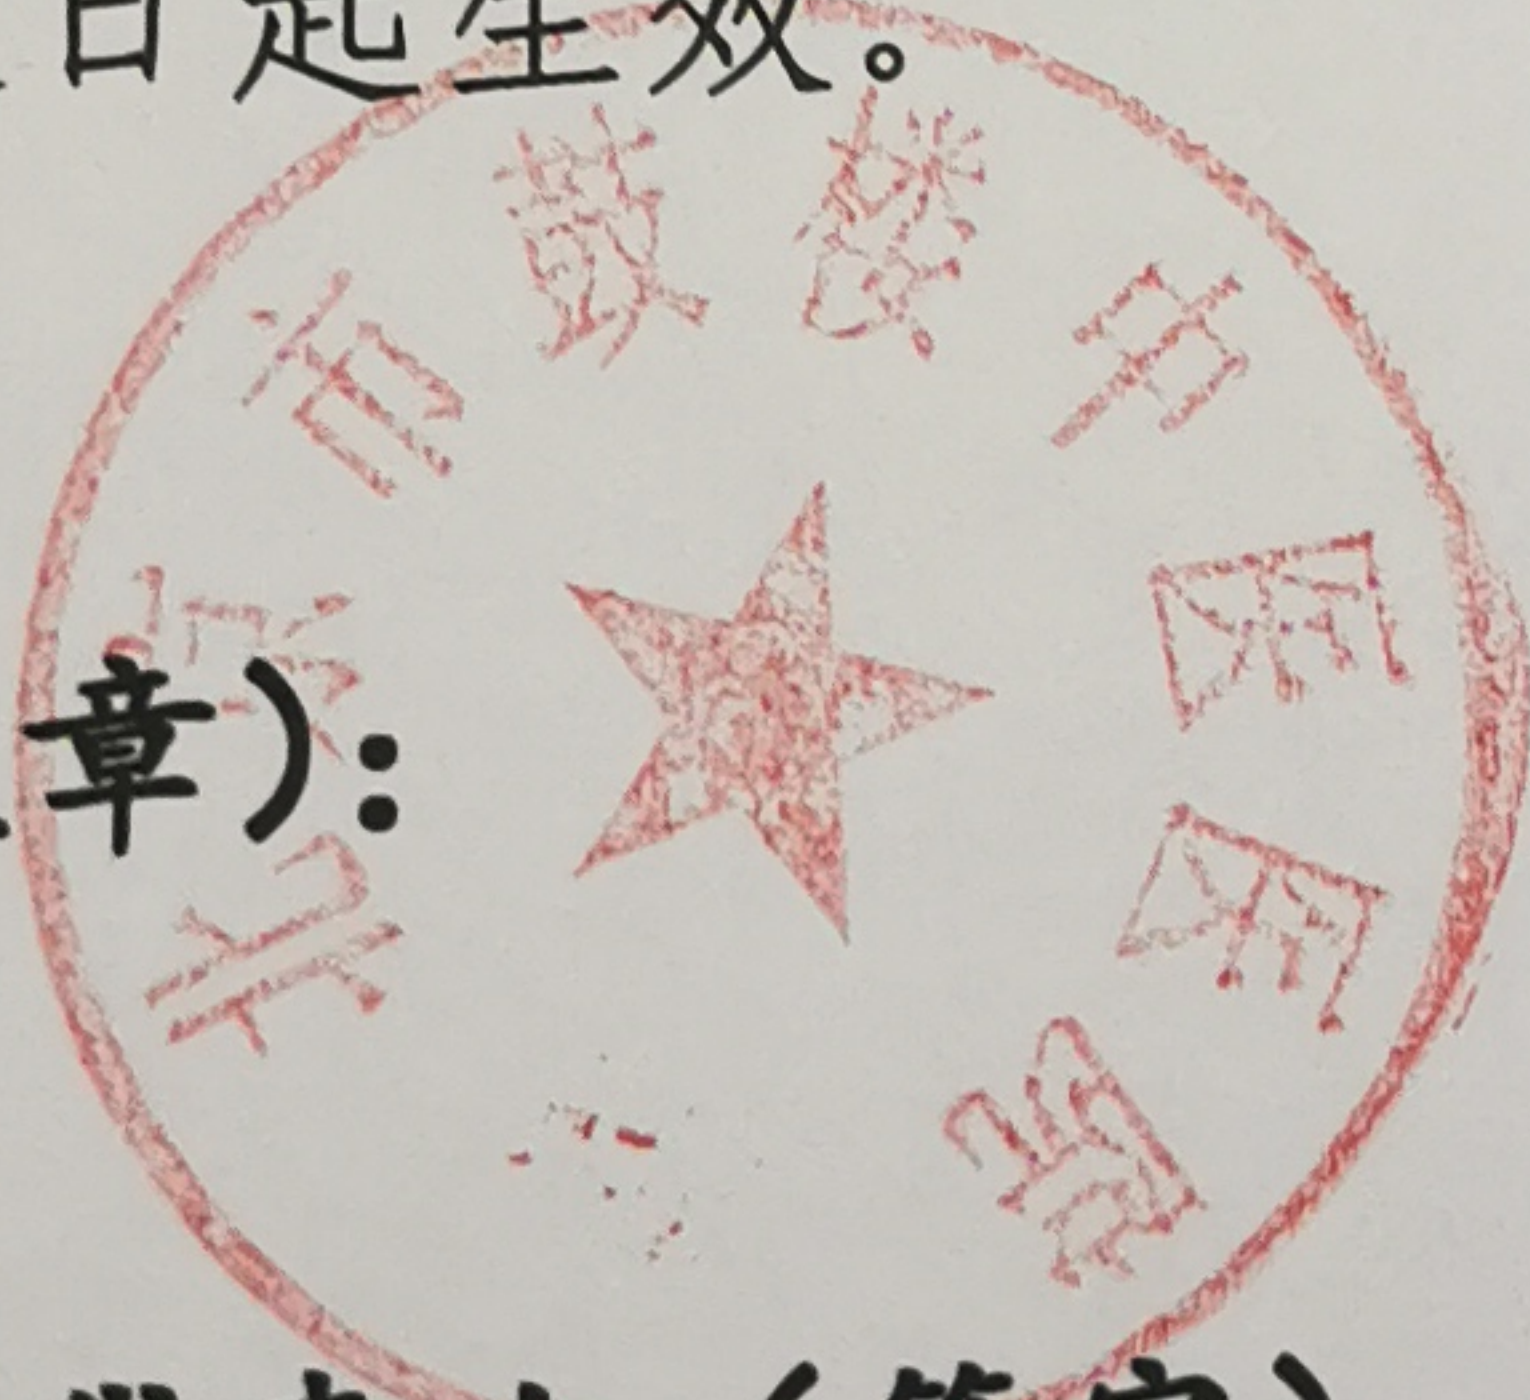

单位法定代表人（签字）：

[Handwritten signature]

乙方（盖章）：



单位法定代表人（签字）：

白小龙

2022年9月13日

2022年9月13日